

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 5115/2006

Згідно з наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 20 квітня 2006 р. № 199

Прилади спеціалізовані визначення концентрації парів етанолу в повітрі, що видихаються, "Алконт 01су", "Алконт 01см", "Алконт 01са"

код медичного виробу, тип, вид, марка тощо

І
клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер у каталозі

9018 19 90 00

код згідно з ЗСТ

внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці.

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "Брестское техническое агентство"**
м. Брест, вул. Суворова, 112, Республіка Білорусь

найменування, країна, місцезнаходження

Свідоцтво дійсне до 28 квітня 2011 р.

Перший заступник
Голови Державної служби  І.Б.Демченко

МП



DC

№006611

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5115/2006 від 28.04.2006
Прилади спеціалізовані визначення концентрації парів етанолу в повітрі, що
видихаються, "Алконт 01су", "Алконт 01см", "Алконт 01са"
виробництва "Брестское техническое агентство" (Республіка Білорусь).

№ п/п	Назва російською мовою	Назва українською мовою
1.	Прибор специализированный определения концентраций паров этанола в выдыхаемом воздухе „Алконт 01см“ ТФАГ 413422.001-01	Прилад спеціалізований для визначення концентрацій парів етанолу в повітрі, що видихається „Алконт 01см“ ТФАГ 413422.001-01
2.	Прибор специализированный определения концентраций паров этанола в выдыхаемом воздухе „Алконт 01су“ ТФАГ 413422.001-02	Прилад спеціалізований для визначення концентрацій парів етанолу в повітрі, що видихається „Алконт 01су“ ТФАГ 413422.001-02
3.	Прибор специализированный определения концентраций паров этанола в выдыхаемом воздухе „Алконт 01са“ ТФАГ 413422.001-03	Прилад спеціалізований для визначення концентрацій парів етанолу в повітрі, що видихається „Алконт 01са“ ТФАГ 413422.001-03
4.	High Energy Lithium Battery 1,5 В/3 Ач 6	Батарея High Energy Lithium Battery 1,5 В/3 Ач 6
5.	Сетевой адаптер БПН12-0,5Е 220 В, 50 Гц/12В, 500 мА	Мережевий адаптер БПН12-0,5Е 220 В, 50 Гц/12В, 500 мА
6.	Мундштук ТФАГ 713423.001	Мундштук ТФАГ 713423.001
7.	Шнур питания от бортовой сети ТФАГ 465139.001	Шнур живлення від бортової мережі ТФАГ 465139.001
8.	Шнур питания от бортовой сети ТФАГ 465139.001-01	Шнур живлення від бортової мережі ТФАГ 465139.001-01
9.	Шнур связи с IBM PC ТФАГ 465644.001	Шнур зв'язку з IBM PC ТФАГ 465644.001
10.	Шнур связи с IBM PC ТФАГ 465644.001-01	Шнур зв'язку з IBM PC ТФАГ 465644.001-01
11.	Программное обеспечение (программа поддержки для IBM PC) „Alcont.exe“ диск 3,5	Програмне забезпечення (програма підтримки для IBM PC) „Alcont.exe“ диск 3,5
12.	Опора ТФАГ 304274.001	Опора ТФАГ 304274.001
13.	Упаковка СТБ 1015	Упаковка СТБ 1015

Перший заступник Голови
Державної служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення

МП



№ 019312

DC

СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ

затвердження типу засобів виміральної техніки

№ UA-MI/3-649-2004


Видане 22 березня 2004 р.

Це свідоцтво, видане ТОВ "Брестское техническое агентство", Республіка Білорусь, за-
являє, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных ис-
пытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерения, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, по-
сле калибровки средств измерения", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом
Білорусії, визнано тип засобів виміральної техніки "Прилади спеціалізовані визначення
концентрації парів етанолу в повітрі, що виділяється, «Алкотест 01с»", затверджений Держ-
комом Республіки Білорусь на підставі результатів державних випробувань.

Прилади спеціалізовані визначення концентрації парів етанолу в повітрі, що виді-
ляється, «Алкотест 01с» зареєстровані в Державному реєстрі засобів виміральної тех-
ніки, допущених до застосування в Україні, за номером 9Б 03 25 0559 97.

Прилади спеціалізовані визначення концентрації парів етанолу в повітрі, що виді-
ляється, «Алкотест 01с» під час експлуатації підлягають повірці з періодичним інтерва-
лом не більше півроку.

Заслупних голів

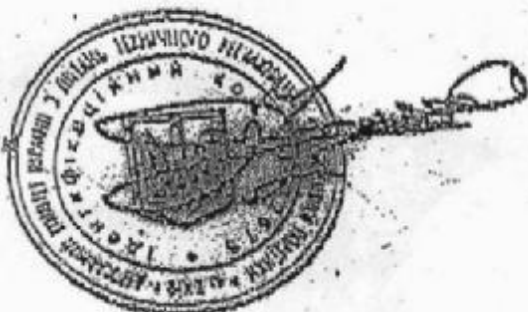

С.Т. Черепков